NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na formování postavy

BeautyRelax BR-2220

CELLUFORM OPTIMAL

OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KONTRAINDIKACE	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
LYMFATICKÉ UZLINY	7
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	10
ULTRAZVUKOVÁ KAVITACE	10
RADIOFREKVENCE	10
ČERVENÉ SVĚTLO	10
MODRÉ SVĚTLO	10
EMS	11
HLAVNÍ VÝHODY	11
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	11
TECHNICKÉ PARAMETRY	11
OBSAH BALENÍ	11
POPIS PŘÍSTROJE	12
POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE	14
SCHÉMA OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK	15
NASTAVENÍ INTENZITY	16
POPIS JEDNOTLIVÝCH MÓDŮ BODY/FACE	17
SCHÉMA POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ	18
ČAS OŠETŘENÍ TĚLA	18
TEST PLETI	19
SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	19
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA MÓD BODY	20
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE MÓD FACE	25
NABÍJENÍ BATERIE	26
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	26
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	27
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	28
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	30
CERTIFIKACE	30
DOVOZCE	30
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	31

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření vybraných částí těla pracuje s technologií, která je bezbolestná a bezpečná. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat podkožní tukovou tkáň, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie masážních/estetických přístrojů. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě obezity ani jiných souvisejících omezení. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají v redukci podkožního tuku.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost adaptéru a všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Ultrazvuk získá lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem

ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast štítné žlázy
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka
- Obličej (pouze v režimu **FACE**)

Poznámka: *párová oblast těla je brána jako jedna partie*

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

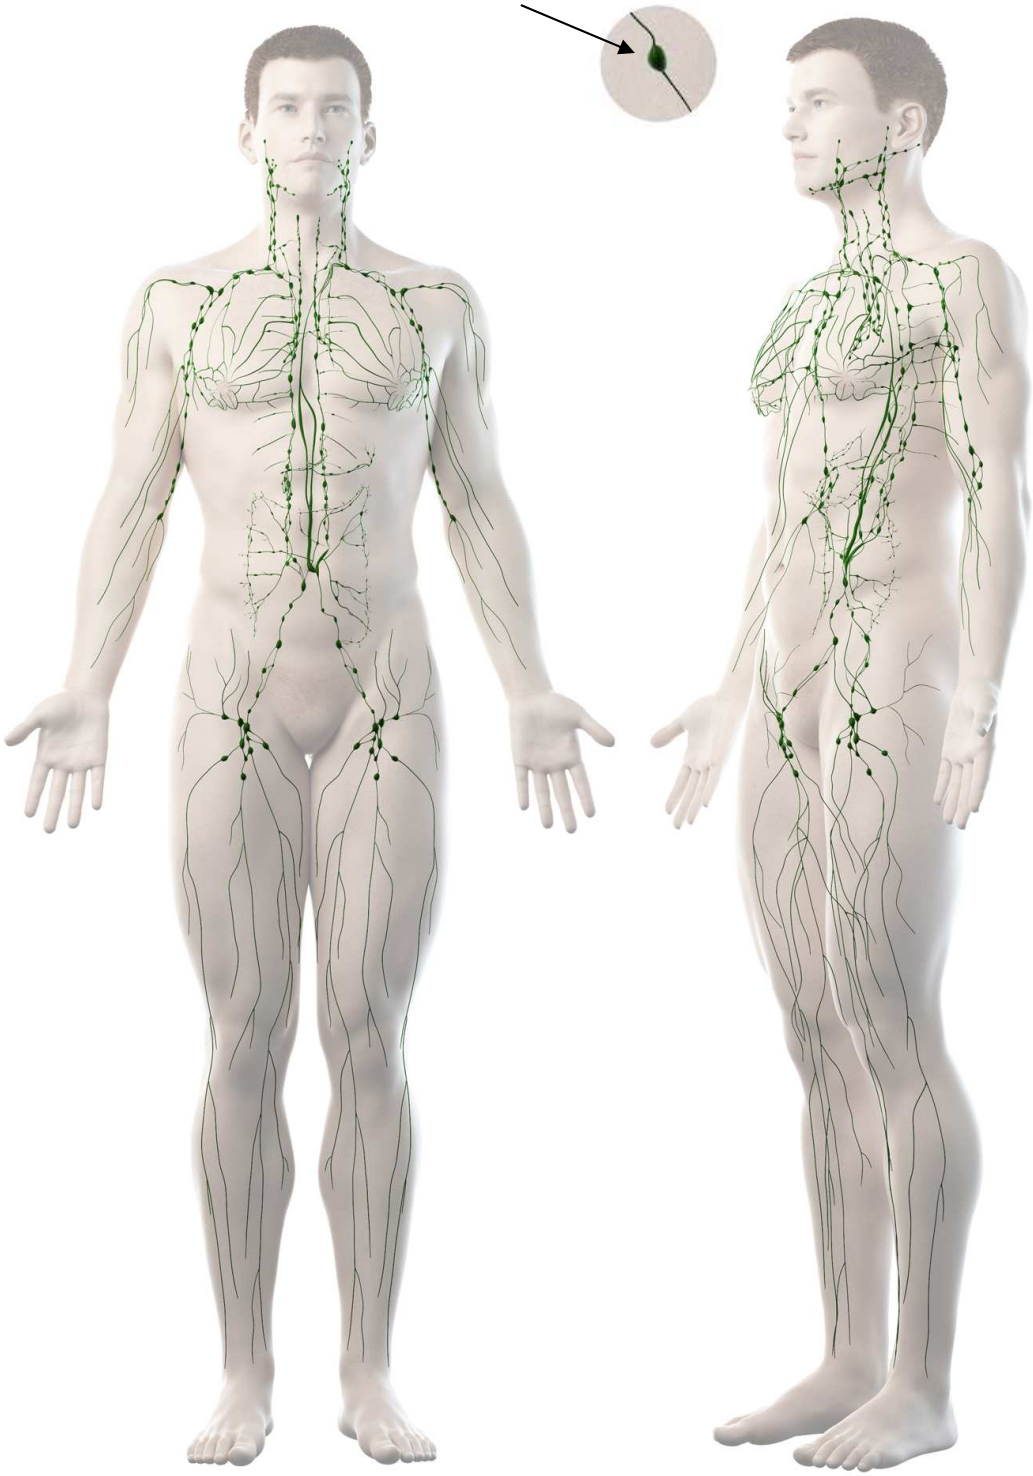

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

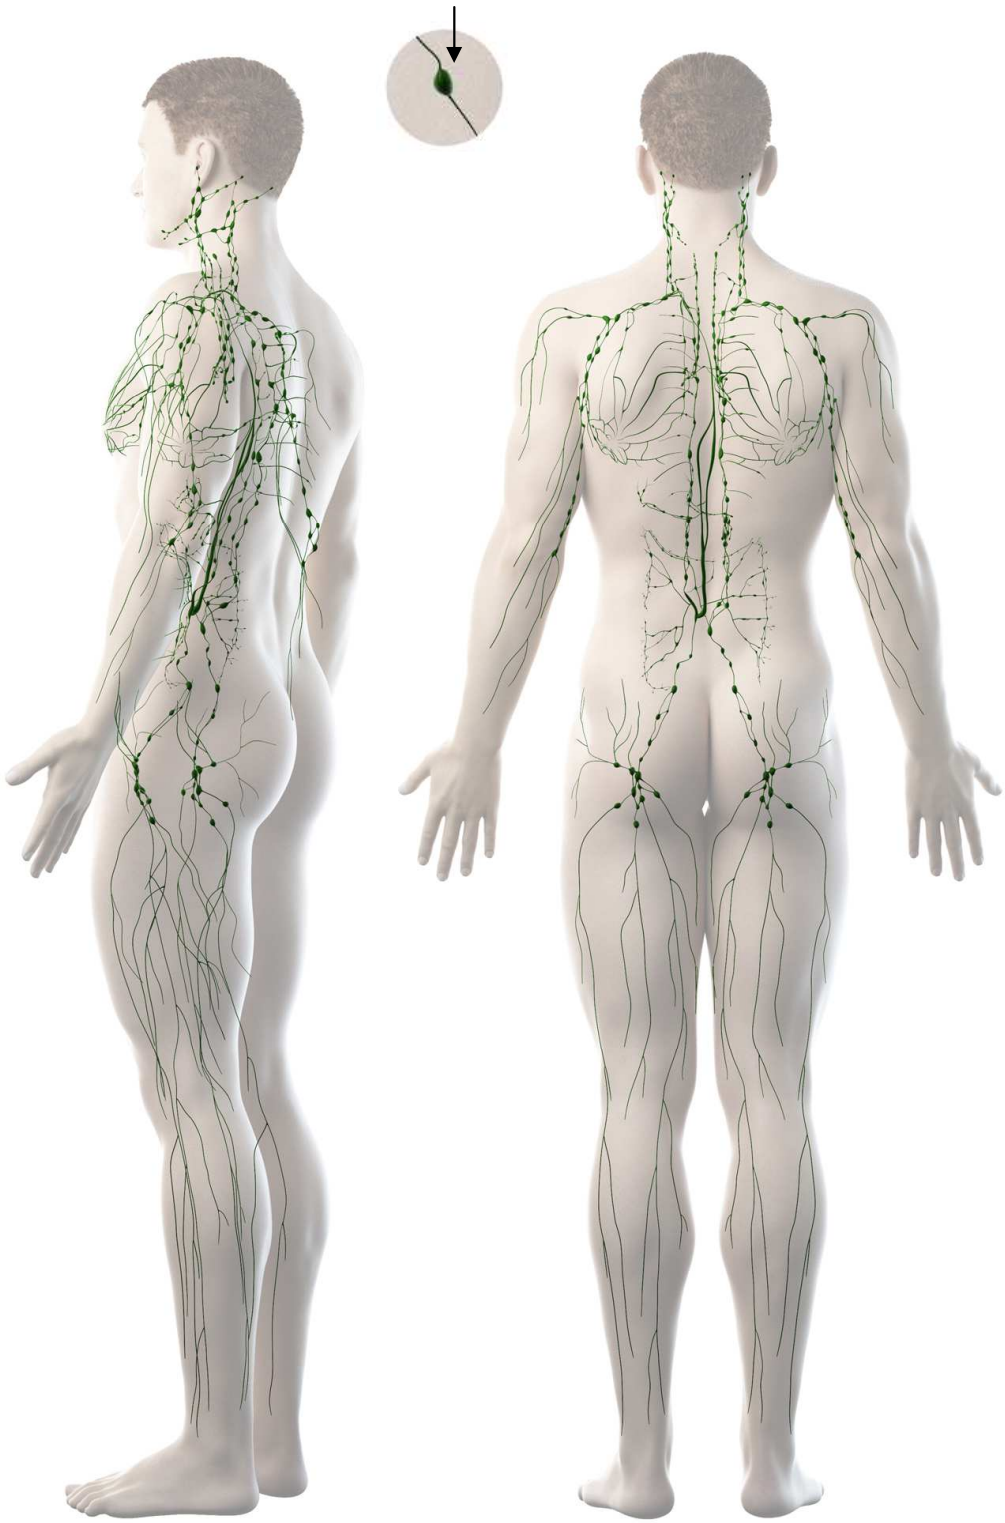

LYMFATICKÉ UZLINY

Při použití přístroje **Beautyrelax** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyby aplikační hlavice s ultrazvukem jsou v těchto oblastech **přísně zakázány**. Oblasti těla, na které se zákaz vztahuje, jsou zobrazeny **velkými zelenými tečkami**:

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Celluform Optimal je estetický přístroj nové generace pro účinné formování postavy. Konstrukce a použité technologie vyhází z přístrojové techniky profesionálních estetických studií. Redukce podkožního tuku, zpevnění povislé pokožky, zmírnění příznaků celulitidy. Hlavní účinky působení vysoce efektivních technologií: ultrazvuk, radiofrekvence, EMS a fotonové světlo. Určeno pro ošetření těla. Naprosto bezpečné používání v domácích podmínkách. BeautyRelax Celluform Optimal představuje optimální řešení pro vaše tělo!

ULTRAZVUKOVÁ KAVITACE

Aplikační hlavice generuje vysokofrekvenční ultrazvukové vlny, které pronikají do podkoží s frekvencí 1MHz. Tkáně následně absorbují takto generovanou energii. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro redukci tuku na nejvíce problematických partií.

RADIOFREKVENCE

Aplikátor po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.

ČERVENÉ SVĚTLO



- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

MODRÉ SVĚTLO

- aktivuje porphyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

EMS

Multifunkční aplikační hlavice modelu BeautyRelax Celluform Optimal generuje jemné elektrické impulzy. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily účinné, ale zároveň bezbolestné ošetření pleti. Dochází ke kontrakci svalů a tím jejich posílení. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.

HLAVNÍ VÝHODY

- 4 inovativní technologie pracující ve 4 různých módech
- lepší dosažitelné výsledky ve srovnání s přístroji obdobného charakteru
- zcela neinvazivní charakter ošetření
- nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity
- bezbolestné a naprosto bezpečné používání
- časová nenáročnost: 1 procedura trvá 15 minut
- bez jakýchkoliv vedlejších účinků

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- dosažitelné a viditelné výsledky i v případech, kdy tuk prorůstá svalovou hmotou
- (zejména u mužů nebo sportovně založených žen)
- odstraňování tuku z problematických partií ženského i mužského těla
- formování význačných kontur na rukou, nohách i na těle
- zpevňování a vypínání pokožky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvuku: 1Mhz
- Červené světlo o vlnové délce 625nm
- Modré světlo o vlnové délce 465nm
- Podsvícený LCD displej
- Časovač
- Indikace stavu baterie
- Provozní napětí: 5V
- Provozní proud: 1A
- Rozměry: 8,5x8,5x8,5cm
- Hmotnost: 250g

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj na formování postavy BeautyRelax BR-2220 CELLUFORM OPTIMAL
- Nabíjecí kabel.
- Nabíjecí adaptér 220V.
- Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE

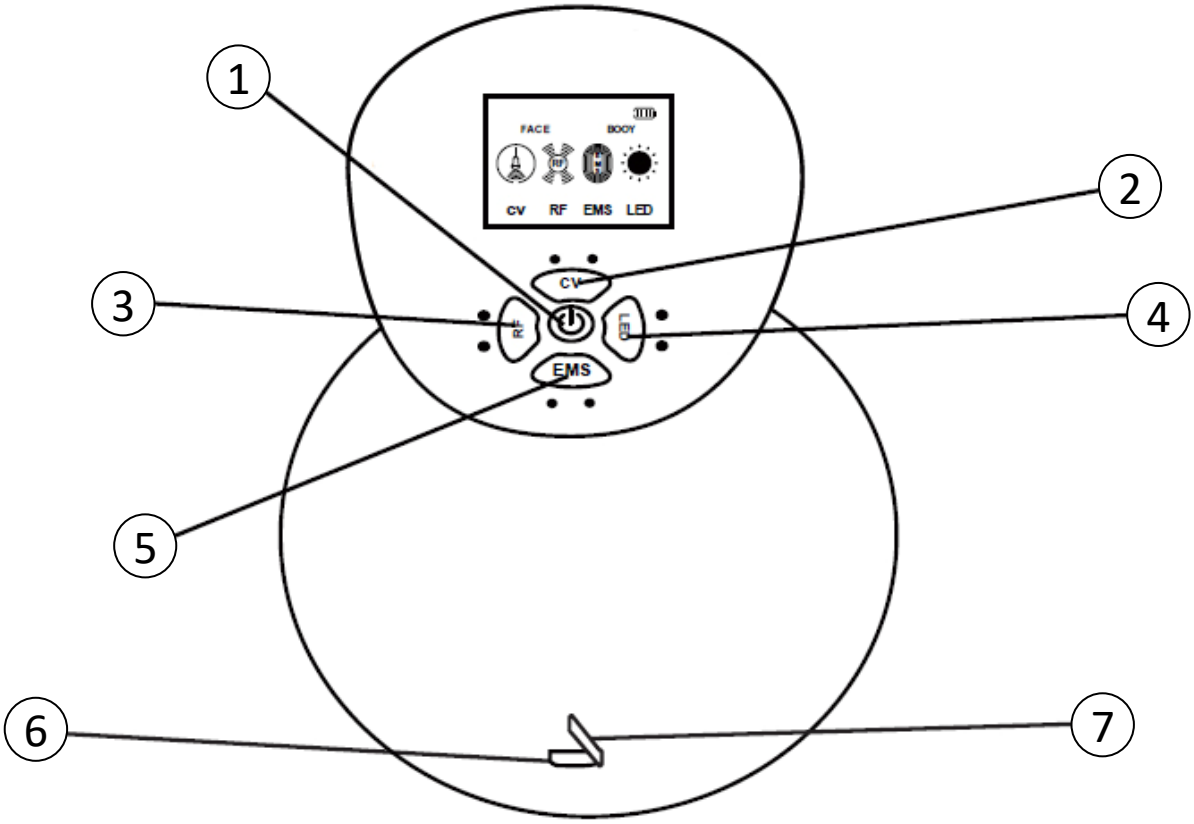

1. Tlačítko ON/OFF

2. Tlačítko ultrazvukové vlny CV

3. Tlačítko radiofrekvence RF

4. Tlačítko fotonového světla LED

5. Tlačítko elektrických pulzů EMS

6. Vstup pro napájecí kabel

7. Kryt napájecího kabelu

POPIS PŘÍSTROJE

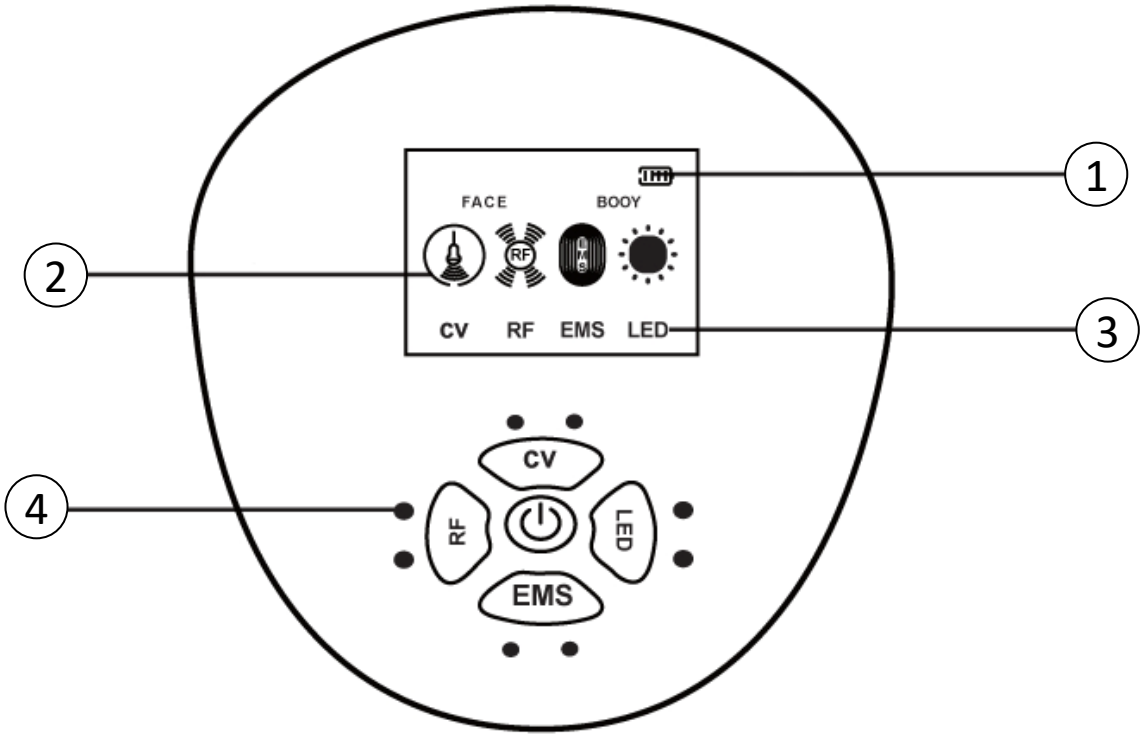

1. Ukazatel stavu baterie

2. Zobrazení aktuálního módu

3. Název módu

4. Indikace úrovně intenzity

POPIS APLIKAČNÍ HLAVICE

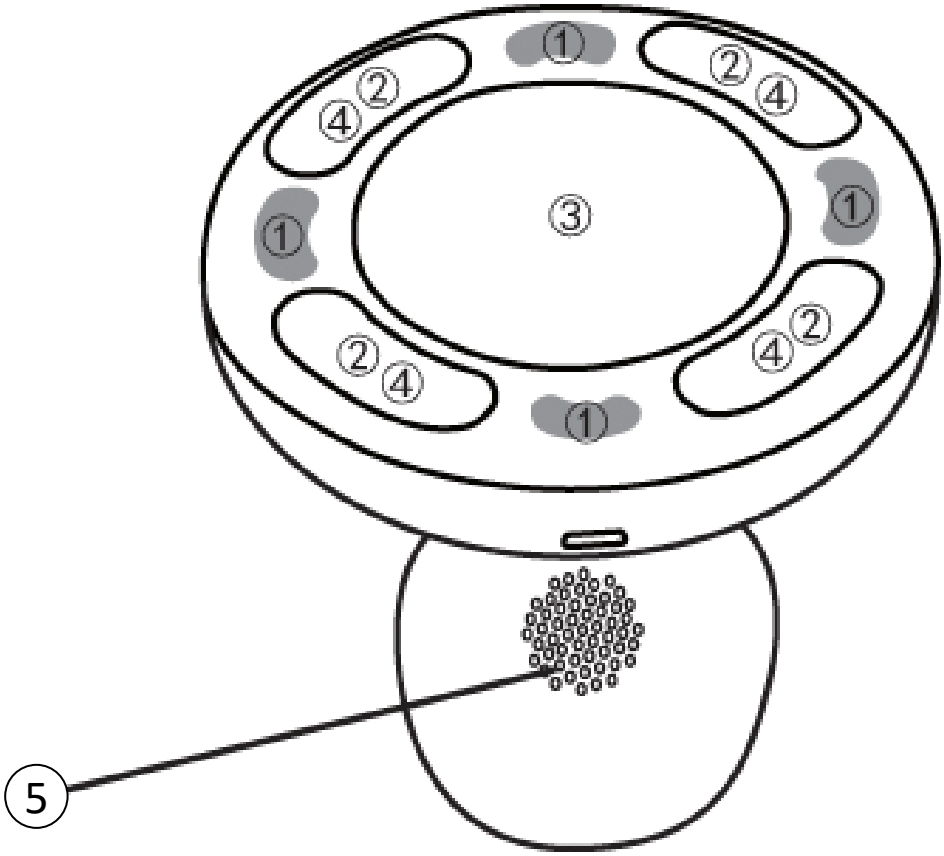

1. Červené a modré světlo

2. Radiofrekvence

3. Ultrazvukové vlny

4. EMS elektrické pulzy

5. Odvětrávání tepla (nikdy nezakrývejte)

SCHÉMA OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Tlačítko	***Funkce***	***Světelná indikace***
	krátce 1s - zapnutí přístroje *krátce 1s - vypnutí přístroje*	
	krátký stisk - změna mezi jednotlivými režimy *mód Body (Tělo) / mód Face (obličej) / ruční volba módů*	
	2 úrovně intenzity	*světelná signalizace u tlačítka LED*
	2 úrovně intenzity	*světelná signalizace u tlačítka CV*
	červené / modré světlo	*světelná signalizace u tlačítka LED*
	2 úrovně intenzity	*světelná signalizace u tlačítka LED*

NASTAVENÍ INTENZITY

Tlačítko ON/OFF
Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se zapne. Činnost přístroje zahájí módem **Body** (Tělo). Dalším krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** přepnete na mód **Face** (Obličej). Dalším stiskem přepnete na volný mód ošetření. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

Dvě úrovně intenzity radiofrekvence RF
Stiskněte 1x **tlačítko RF** = nízká úroveň **1**. Stiskněte 2x **tlačítko RF** = vysoká úroveň **2**. Jednotlivé úrovně doprovází světelná signalizace.

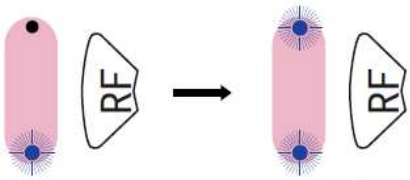

Dvě úrovně intenzity ultrazvuku CV
Stiskněte 1x tlačítko CV = nízká úroveň 1. Stiskněte 2x tlačítko CV = vysoká úroveň. Jednotlivé úrovně doprovází světelná signalizace.

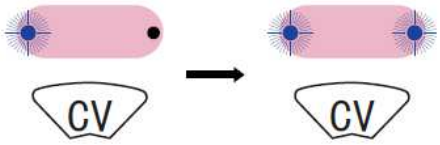

Dvě úrovně intenzity ultrazvuku CV
Stiskněte 1x tlačítko CV = nízká úroveň 1. Stiskněte 2x tlačítko CV = vysoká úroveň. Jednotlivé úrovně doprovází světelná signalizace.



Dvě úrovně elektrických pulzů EMS
Stiskněte 1x tlačítko EMS = nízká úroveň 1. Stiskněte 2x tlačítko EMS = vysoká úroveň. Jednotlivé úrovně doprovází světelná signalizace.

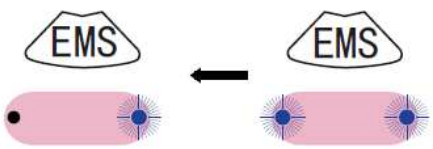

Poznámka

Každý mód má automatický časovač v délce 10 minut (čas se neresetuje v případě změny intenzity). Po uplynutí 10 minut se přístroj přepne do režimu pohotovostního režimu. Poté si můžete pomocí tlačítka ON/OFF zvolit nový režim použití přístroje. LCD displej zobrazí příslušnou ikonku dle nastaveného módu použití přístroje.

POPIS JEDNOTLIVÝCH MÓDŮ BODY/FACE

Masážní přístroj má velkou výhodu oproti přístrojům obdobného typu. Úpravou výkonu je možné použít na tělo i obličej. Celluform Optimal tak zahrnuje dva přístroje do jednoho. Přístroj nabízí multifunkční ošetření pleti ve dvou základních módech: Body (Tělo), Face (Obličej).

Mód ošetření těla - BODY

Časovač v délce 10 minut. Radiofrekvence s vysokou intenzitou + červené LED světlo (RF + LED 2 světelné indikátory) pracují 2 minuty. Ultrazvukové vlny s vysokou intenzitou + červené světlo (CV + LED 2 světelné indikátory) pracují 3 minuty. Radiofrekvence s vysokou intenzitou RF + EMS (každý 10 sekund) + červené LED světlo (2 světelné indikátory) pracují 5 minut.

Mód ošetření obličeje - FACE

Časovač v délce 10 minut. Radiofrekvence s nízkou intenitou + modré LED světlo (1 RF + LED 2 světelné indikátory) pracují 3 minuty. Ultrazvukové vlny s nízkou intenzitou + modré světlo (1 CV + LED 2 světelné indikátory) pracují 2 minuty. EMS elektrické pulzy v nízké intenzitě + modré LED světlo (1 EMS + 2 LED světelné indikátory) pracují 2 minuty. Radiofrekvence s nízkou úrovní intezity + EMS střídavě (každá funkce 10 sekund) + modré LED světlo (1 EMS + 1RF + 2 LED světelný indikátor) pracují v délce 3 minut.

Funkce automatického vypnutí

Po uplynutí 10 minut se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. V případě další nečinnosti v průběhu 2 minut se přístroj automaticky vypne.

Upozornění

Než se s přístrojem dokonale seznámíte a osvojíte si všechny jeho funkce a vlastnosti, začínejte na nízké úrovni intenzity ošetření. Úroveň intenzity svolte tak, aby vám bylo používání přístroje příjemné.

SCHÉMA POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

Tlačítko	*Význam*	*Oblast ošetření těla*	*Frekvence použití*
	potlačení projevů celulitidy / zvýšení pružnosti pleti	*obličej/tělo*	*15 minut při jednom ošetření / den*
	redukce tukové tkáně	*obličej/tělo*	
	neinvazivní ošetření kožních buněk	*obličej/tělo*	
	posílení svalové tkáně	*obličej/tělo*	

ČAS OŠETŘENÍ TĚLA

Čas ošetření by neměl přesáhnout **15 minut.** V případě párové části těl rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno.

Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne. Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní.

Příklad rozvrhu ošetření těla

Pondělí	*Úterý*	*Středa*	*Čtvrtek*	*Pátek*	*Sobota*	*Neděle*
paže + lýtka	*volno*	*volno*	*stehna + lýtka*	*volno*	*volno*	*volno*

Proč volné dny?

Při ošetření těla estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukové kavitace je nezbytně nutné dát tělu nějaký čas, aby mohlo přirozenou cestou zpracovat uvolněnou energii. Tukové buňky se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.

TEST PLETI

Každý jsme originál. Existuje celá řada typů pleti. Přestože je používání přístroje naprosto bezpečné, je doporučeno provést test pleti, zda použití nevyvolá případné nežádoucí podráždění pleti či alergickou reakci.

1. Naneste na pleť tenkou vrstvičku vodivého gelu
2. Ošetřete malou část pleti krouživými pohyby postupně střídáním technologií RF, CV a EMS v délce 3 minut.
3. Nezapomeňte nastavit nejnižší úroveň intenzity 1.
4. Pokud se v průběhu 24 hodin na pleti neobjeví jakékoliv nestandardní zbarvení vlivem alergické reakce, přístroj můžete bez obav používat dle instrukcí v tomto návodu k obsluze.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Při používání vždy dbejte na to, aby byla aplikační plocha v plném rozsahu s pletí. V opačném případě nebude přístroj působit správně.

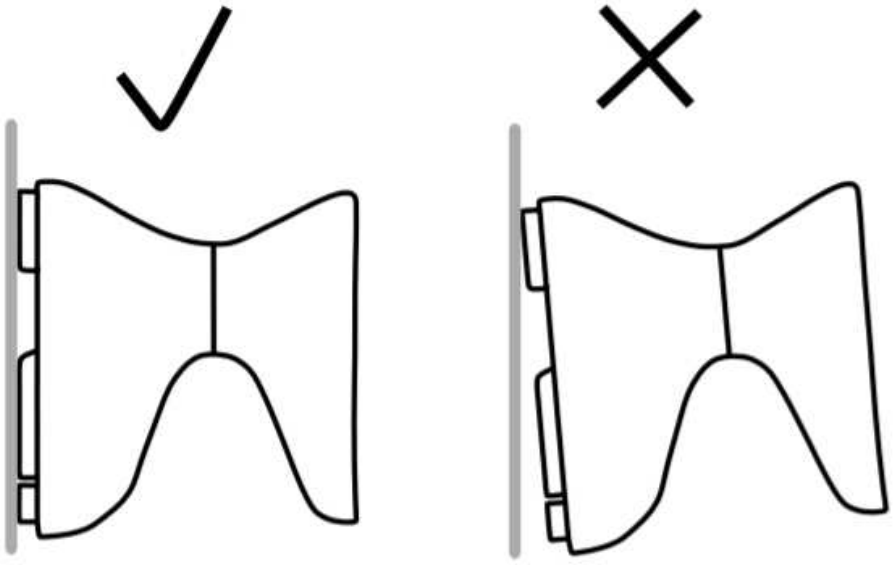

Správné použití *Nesprávné použití*

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ TĚLA MÓD BODY

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE

PAŽE

Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na rukou. Aplikační hlavicí přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.

Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast bříška. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

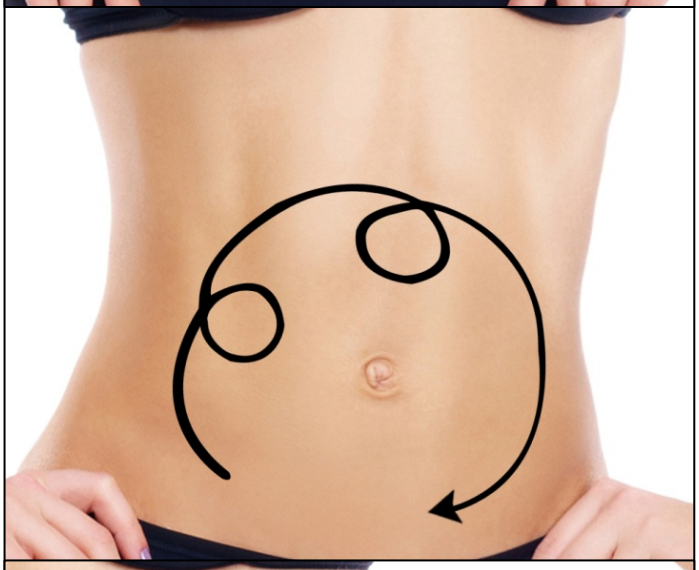

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast bříška. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

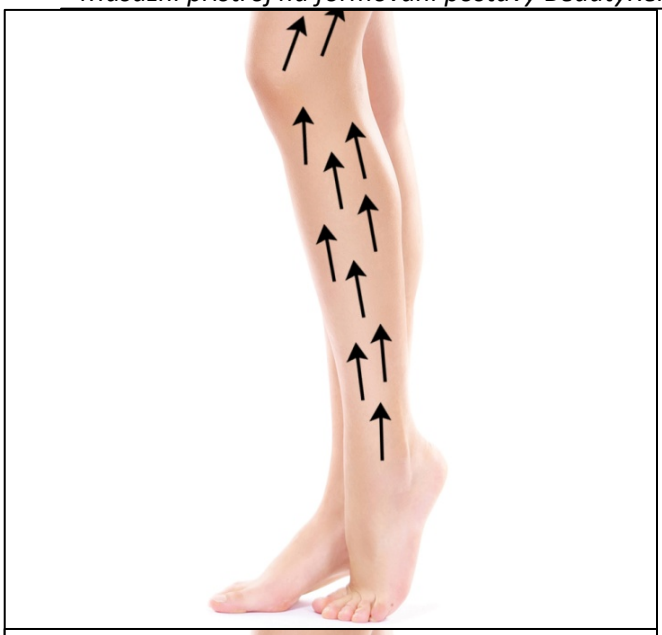

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.

Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.

MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE MÓD FACE

ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu

NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů

TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru

BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

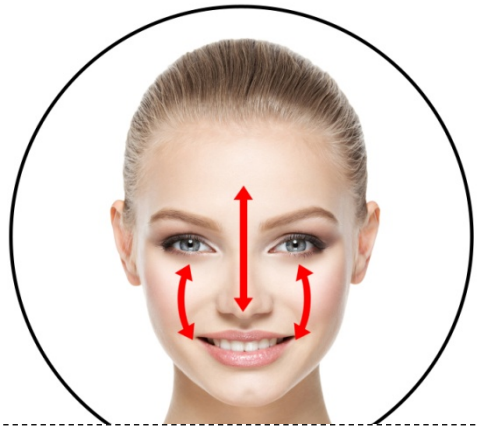

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech

Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii napětím. Jakmile je baterie vybita, přístroj se automaticky vypne. Stav baterie signalizuje ikona baterie na displeji.

Postup nabíjení:

1. Zapojte kabel do síťového adaptéru, který je součástí balení.
2. Druhý konec kabelu připojte do vstupu na boční straně přístroje.
3. Délka nabíjení závisí na stavu baterie.
4. Průběh nabíjení indikuje ikona baterie na displeji.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj není možné zapnout	Nestiskli jste tlačítko ON/OFF dostatečně dlouho	Stiskněte znovu dlouze tlačítko ON/OFF
	Baterie je vybita	Baterii nabijte
Přístroj se po pár minutách automaticky vypne	Nízký stav baterie	Baterii nabijte
	Je třeba provést restart	Přístroj vypněte a znovu zapněte
Přístroj není možné nabít	USB kabel není dostatečně připojen	Kabel znovu připojte správně k přístroji
	Baterie je nabita	Ikona baterie na displeji je plná
Necítím působení radiofrekvence	Pokožka je příliš suchá	Naneste na pleť větší množství kontaktního gelu
	Úroveň intenzity je nízká	Zvyšte intenzitu na úroveň 2
	Aplikační hlavicí se pohybujete příliš rychle	Doporučená rychlost pohybu 2-5cm za sekundu
	Kontaktní elektrody nejsou v plném kontaktu s pletí	Kontaktní plocha přístroje musí být s pletí v plném rozsahu
Radiofrekvence příliš pálí	Zůstáváte s přístrojem na jednom místě příliš dlouho	Doporučená rychlost pohybu 2-5cm za sekundu
	Kontaktní elektrody nejsou v plném kontaktu s pletí	Kontaktní plocha přístroje musí být s pletí v plném rozsahu
	Úroveň intenzity je vysoká	Snižte intenzitu na úroveň 1
Necítím působení EMS	Pokožka je příliš suchá	Naneste na pleť větší množství kontaktního gelu
	Úroveň intenzity je nízká	Zvyšte intenzitu na úroveň 2
	Aplikační hlavicí se pohybujete příliš rychle	Doporučená rychlost pohybu 2-5cm za sekundu
	Kontaktní elektrody nejsou v plném kontaktu s pletí	Kontaktní plocha přístroje musí být s pletí v plném rozsahu
Cítím působení ultrazvuku příliš	Pocit vibrací a mírného pískání není závada	Jedná se o průvodní jev
Přístroj generuje hluk během použití	Mírné pískání není závada	Jedná se o průvodní jev

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?
Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření ultrazvukovou kavitací přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?
Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejezte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvyšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel. Všechny tyto faktory zatěžují vaše játra, která jsou již tak zatížena filtrováním uvolněných tuků z vašeho těla. Další jejich zatížení by mohlo vést k nevolnosti či zhoršení zdravotního stavu. Po ošetření doporučujeme mírně zvýšit pohybovou aktivitu. Podpoříte tím výrazně krevní oběh a celkovou látkovou výměnu. Stimulace krevního oběhu a lymfatického systému podpoří vyplavení uvolněných tuků přirozenou cestou ven z těla.

Bolí ošetření estetickým přístrojem s funkcí ultrazvukové kavitace?
Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné.

Jak poznám, že aplikační hlavice opravdu generuje ultrazvukové vlny?
Během ošetření můžete slyšet slabé pískání, které vydává ultrazvuk. Citliví jedinci můžou cítit jemné mravenčení. Pro ověření funkčnosti ultrazvukových vln naneste drobné množství kapek vody na aplikační hlavici. Ultrazvukové vlny molekuly vody rozkmitají.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?
Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku (zda je prorostlý až do svalové tkáně), stavu lymfatického systému nebo životosprávě. Za optimálních podmínek se může jednat až o několikacentimetrový úbytek po opakovaném ošetření při dodržení výše uvedené životosprávy. Estetický přístroj s funkcí ultrazvukové kavitace vnímejte jako užitečný nástroj, který vám napomůže ve vašem úsilí vypadat lépe. Pro dosažení vysněných cílů je třeba upravit životosprávu a zvýšit pohyb (mluvíme stále o lehké pohybové aktivitě, žádná extrémní fyzická zátěž, na kterou nejste případně zvyklí). Je to důležité, aby procesy, které estetický přístroj ve vašem těle nastartuje, mohly úspěšně a efektivně proběhnout.

Je používání estetického přístroje s ultrazvukovou kavitací bezpečné?
Pokud se přístroj používá na správných partiích a uživatelé neodpovídají některým z uvedených kontraindikací, je ultrazvuková kavitace naprosto bezpečná. Uvolněný tuk je organizmus schopen postupně zpracovat. Výkon je speciálně nastaven tak, aby nedošlo k poškození ostatních buněk a cév. Znovu připomínáme, že je ošetření vždy spojeno se sonogelem. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pokožku dostatečně navázat.

Jaké zásady je nezbytné dodržovat, aby se požadovaný hubnoucí účinek dostavil?
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, je nezbytné upravit životosprávu a zvýšit příjem tekutin. Ošetření ultrazvukovou kavitací můžete bez obav podstoupit již po 7 až 10 dnech. Nedoporučujeme

ošetření více než dvou partií najednou. Pokud ošetřujete partie, které jsou blíže u sebe, efekt kavitace se násobí. V opačném případě (vzdálenějších partií) se efekt rozdělí. Rozhodně se vždy snažte vyhnout těm částem těla, kde jsou lymfatické uzliny - viz. grafická vizualizace v tomto návodu k obsluze, pasáž: **LYMFATICKÉ UZLINY**. Případný letmý náhodný pohyb nevadí. Aplikační hlavice však nesmí tyto vybrané části přímo stimulovat. Správná funkce lymfatických uzlin a dlouhodobá stimulace pomocí ultrazvukových vln se neslučují.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?
Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

Může přístroj používat více osob?
Ano. Je to možné, ale za dodržení určitých podmínek. Věnujte zvýšenou pozornost zejména dezinfekci aplikační hlavice. Zabráníte přenosu bakterií či případně kožních chorob. Pro dezinfekci použijte ideálně alkoholový roztok ve spreji. Povrch aplikační hlavice vždy důkladně osušte.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?
Doporučená délka individuálního ošetření by neměla přesáhnout 15 minut.

Je přístroj zdravotnický prostředek?
Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj poskytuje technologie, které napomáhají v boji proti redukci podkožního tuku.

Má přístroj nějakou certifikaci?
Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Kde se přístroj vyrábí?
Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Je přístroj vodotěsný?
Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod tekoucí vodou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

CE Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00
IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj na formování postavy

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax Celluform Optimal BR-2220**
EAN **8594166118980**
je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2017 **EN 61000-3-2: 2014**
EN 61000-3-3: 2013 **EN 55014-2: 2015**
EN 60335-1: 2012+A11:2014+A13:2017 **EN 62233: 2008**
EN 60335-2-23: 2003+A1: 2008+A11: 2010+A2:2015

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny v test reportech:
TB191124289 + TB191124288

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.

RoHS compliant

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Místo vydání: Brno
Datum vydání: 1.4.2021

.....
Martin Hrbek, jednatel